PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

A61B 5/0205

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 97/14354

A2

DE

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum:

NL, PT, SE).

24. April 1997 (24.04.97)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP96/04497

(22) Internationales Anmeldedatum: 16. Oktober 1996 (16.10.96)

(30) Prioritätsdaten:

195 38 473.3

16. Oktober 1995 (16.10.95)

Veröffentlicht

Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,

(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, US, europäisches Patent (AT,

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): MAP MEDIZINTECHNIK FÜR ARZT UND PATIENT GMBH [DE/DE]; Fraunhoferstrasse 16, D-82152 Martinsried (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GRIEBEL, Peter [DE/DE]; Türkenfelderstrasse 31, D-86926 Pflaumdorf (DE).

(74) Anwalt: VOSSIUS & PARTNER; Siebertstrasse 4, D-81675 München (DE).

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR THE QUANTITATIVE ANALYSIS OF SLEEP DISTURBANCES

(54) Bezeichnung: VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR QUANTITATIVEN ANALYSE VON SCHLAFSTÖRUNGEN

(57) Abstract

The invention concerns a method and device for detecting, recording and quantitatively analyzing sleep disturbances, sleep-related respiratory disturbances, cardiac rhythm disturbances, myoclonia, variations in blood pressure, depth of sleep parameters, movement parameters and disturbance parameters for the quality control of diagnoses for both in- and out-patients. According to the invention, various sensors (4-12) are used to detect a patient's body functions which are stored in a recorder (3). The stored data are then transferred to a computer (1) where they are analysed and evaluated.

(57) Zusammenfassung

Es wird eine Vorrichtung und ein Verfahren zur stationären und ambulanten Aufnahme, Aufzeichnung und quantitativen Analyse von Schlafstörungen, schlafbezogenen Atmungstörungen, Herzrhythmusstörungen, Myoklonien, Blutdruckschwankungen, Schlaftiefeparametern, Bewegungsparametern und Störparametern zur Qualitätssicherung der Diagnostik

beschrieben. Dabei werden über verschiedene Sensoren (4-12) Körperfunktionen eines Patienten erfaßt und in einem Recorder (3) abgespeicherte. Die gespeicherten Daten werden anschließend an einen Rechner (1) übertragen und dort analysiert und ausgewertet.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AT	Österreich	GE	Georgien	NE	Niger
AU	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BE	Belgien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland
BF	Burkina Faso	IE	Irland	PL	Polen
BG	Bulgarien	IT	Italien	PT	Portugal
BJ	Benin	JP	Japan	RO	Rumänien
BR	Brasilien	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SG	Singapur
CG	Kongo	KZ.	Kasachstan	SI	Slowenien
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SK	Slowakei
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
CM	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LK	Litauen	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
EE	Estland	MG	Madagaskar	UG	Uganda
ES	Spanien	ML	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	MN	Mongolei	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
GA	Gabon	MW	Malawi		

WO 97/14354 PCT/EP96/04497

Vorrichtung und Verfahren zur quantitativen Analyse von Schlafstörungen

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Verfahren zur quantitativen Analyse von Schlafstörungen, insbesondere zur stationären und ambulanten Aufnahme, Aufzeichnung und Analyse von schlafbezogenen Atmungsstörungen, Herzrhythmusstörungen, Myoklonien, Blutdruckschwankungen, Schlaftiefeparametern, Bewegungsparametern und Störparametern.

Eine stetige Zunahme der Zahl von Personen, die unter Schlafstörungen leiden und die damit verbundene Überlastung von Schlaflaboratorien, die diese Störungen behandeln, hat dazu geführt, die Untersuchung bzw. Messung von Störungen mittels ambulanter Geräte aus dem stationären in den ambulanten Bereich hin zu verlagern. Die Patienten erhalten Anweisungen darüber, wie die mit diesen Geräten verbundenen Sensoren zu behandeln sind und liefern das mobile Aufzeichnungsgerät nach der Meßzeit wieder beim behandelnden Arzt ab, der daraufhin die aufgezeichneten Meßsignale analysiert, um anschließend zu diagnostizieren. Diese ambulante Methode ist aufgrund des mit einer Messung verbundenen hohen Zeitaufwands sehr kostengünstig und außerdem werden die Ergebnisse nicht dadurch beeinflußt, daß die Messungen in eine für den Patienten ungewohnten Umgebung durchgeführt werden.

Ein solcher ambulanter Recorder wird in der EP-A-0 356 603 beschrieben. Dieser Recorder ermöglicht, über acht Kanäle Meßsignale aufzunehmen, diese zu speichern und anschließend in einem Computer zu analysieren. Dabei ist es möglich, den Recorder unterschiedlich zu programmieren, um somit durch eine Vorauswahl die Anzahl der gemessenen Daten zu reduzie-

ren und eine Beschränkung auf gewünschte Meßdaten je nach Krankheitsbild oder Diagnosezweck zu erreichen. Durch diese unterschiedliche Programmierung läßt sich die Messung auf verschiedene Rahmenbedingungen anpassen.

PCT/EP96/04497

Die Messung verschiedener Parameter zur Erkennung von Schlafstörungen wird in der DE-A-41 38 702 erläutert. darin offenbarte Vorrichtung weist Sensoren zur Erfassung des Herzpotentials, der Atmungs- bzw. Schnarchlaute, Sauerstoffsättigungsgrades des Blutes und der Positionen des Körpers des Patienten auf. Eine Analyse der Meßergebnisse erlaubt die Diagnose von Apnoe. Dieses Analysegerät ist allerdings auf einen einzigen Anwendungsfall, nämlich die Erkennung von Schlafstörungen (Apnoe) beschränkt und besitzt mit den erwähnten Sensoren ein nur auf diesen Zweck zugeschnittenes Instrumentarium zur Analyse. Insbesondere lassen sich zwar schlafbezogene Atmungsstörungen erkennen, jedoch nicht damit verbundenen "Nebenwirkungen", wie etwa Herzrhythmusstörungen.

Zum allgemeinen Stand der Technik wird ferner verwiesen auf DE 92 04 190 U1, DE 32 48 222 A1, DE 39 21 784 A1, US 3 734 086, DE 92 00 249 U1 und Kurz, Roland: "Medizinische Meßtechnik und Biosignalverarbeitung in der kardiologischen Diagnostik", M.-G.-Schmitz-Verlag Gießen 1984, S. 122 - 129, ISBN 3-922 272-23-1

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur quantitativen Analyse von Schlafstörungen bereitzustellen, mit der im Schlaf auftretende Störungen genauestens und umfassend erfaßt werden, so daß neben der Analyse dieser Störungen auch daraus resultierende Störungen anderer Körperfunktionen erkannt werden können. Insbesondere soll mit der Vorrichtung und dem Verfahren die Erkennung von auf Schlafstörungen beruhenden Herzrhythmusstörungen (sog. "Apnoe-assoziierten Herzrhythmusstörungen") er-

möglicht werden. Diese Aufgaben werden mit den Merkmalen der Ansprüche gelöst.

Bei der Lösung geht die Erfindung von folgenden Grundgedanken aus.

Um eine schnelle und genaue Analyse von Schlafstörungen und damit verbundenen Störungen durchführen zu können, ist es von großer Bedeutung, welche Körpersignale aufgenommen werden bzw. wieviele Parameter notwendig sind, um aus einer Korrelation oder einem Vergleich dieser Signale heraus auf die Ursache der Störungen schließen zu können. Aus diesem Grund besteht bei der vorliegenden Erfindung die Möglichkeit, das Herzpotential, den Blut-Sauerstoffgehalt, die Körperlage, Körperbewegungen, Atmungslaute, den Beatmungsdruck, den Atemfluß, die Atemtätigkeit und andere elektrophysiologische Meßwerte über verschiedene Sensoren zu messen und somit ein umfassendes Datenmaterial für die Analyse bereitzustellen. Die Meßsignale werden von den Sensoren an einen tragbaren Recorder geliefert, dort zwischengespeichert und nach dem Meßzyklus von einer Recheneinrichtung, wie etwa einem PC ausgelesen und verarbeitet. Der Recorder besitzt dazu eine Speicherkarte als externen Speicher. Diese wird für die Aufzeichnung der Signale verwendet und wird außerdem vor dem Meßbeginn für die anstehende Anwendung programmiert. So können durch die Auswahl eines entsprechenden Programmes angesprochen werden. gezielt bestimmte Sensoren Zweiteilung der Hardwarekomponenten ermöglicht einen beliebigen stationären oder mobilen Einsatz der Vorrichtung. Zur Analyse der Meßdaten lassen sich diese zum einen direkt in unveränderter Form auf dem Bildschirn des PCs anzeigen, wobei natürlich beliebige Zeitbereiche ausgewählt werden können, zum anderen dienen die Daten jedoch auch als Grundlage für eine Auswertung, durch die weitere Kenngrößen ermittelt werden können. So wird z.B. das Herzpotentialsignal einem Herzfrequenzanalysator zugeführt, der daraus die Veränderungen der Herzfrequenz oder über eine Korrelation mit anderen

Meßwerten oder Histogrammdarstellungen ermittelt. Weiterhin werden die Meßsignale mittels geeigneter Rechenverfahren derart aufbereitet, daß z.B. eine Darstellung in Form von Tabellen oder Histogrammen erfolgen kann. Insbesondere die Sauerstoffsättigung des Blutes, die Positionswechsel des Patienten, Schnarchtätigkeiten und Atemstörungen lassen sich so übersichtlich und aussagekräftig darstellen.

Bei der Therapiekontrolle wird der Beatmungsdruck der Überdruckbeatmungsgeräte mitregistriert.

Mit einer Korrelation oder einem Vergleich dieser Daten können z.B. Schlafstörungen, Atmungsstörungen, Herzrhythmusstörungen erkannt werden. Insbesondere besteht der Vorteil, daraus Herzrhythmusstörungen zu erkennen, die auf Schlafstörungen beruhen. Gerade diese Art von Herzrhythmusstörungen läßt sich mit herkömmlichen Methoden wie z.B. Antiarythmika oder Herzschrittmachern nicht zufriedenstellend behandeln. Wenn jedoch ein ursächlicher Zusammenhang zwischen diesen Herzrhythmusstörungen und Schlafstörungen gezeigt werden kann, lassen sich die Herzrhythmusstörungen kausal durch eine Behandlung der Schlafstörungen beheben.

Um die Effektivität der Analyse zu erhöhen, werden außerdem Störsignale der Umgebung, sowie ein Absinken der Versorgungsspannung für die Auswertung berücksichtigt. Eine Überwachung der Versorgungsspannung verhindert einen Datenverlust, da bei einem Spannungsabfall die bis dahin gemessenen Daten gespeichert werden und für eine Auswertung zur Verfügung stehen. Die über die Sensorleitungen eingekoppelten Störsignale werden in verschiedene Frequenzbereiche gefiltert und können dann mit den Nutzsignalen verglichen werden, um so die auf Störfelder zurückgehenden Signalanteile in den Nutzsignalen zu lokalisieren. Diese Störanteile können somit bei der Analyse unberücksichtigt bleiben.

Weiterhin sind Alarmgeber vorgesehen, die beim Erreichen bestimmter Schwellwerte des Blutsauerstoffgehalts oder der

Herzfrequenz auslösen und somit die Anwendung des Gerätes auch bei Risikopatienten zulassen.

Der Recorder ist vorteilhafterweise mit einer Echtzeituhr ausgestattet, so daß zum einen eine Echtzeitdarstellung der Signale, zum anderen ein Einsatz während eines ganz bestimmten Zeitraumes möglich ist. Dazu wird der Recorder in einen "Sleep"-Modus versetzt, und die Messungen beginnen erst zu einem gewünschten Zeitpunkt. Dies hat besondere Vorteile, wenn der Recorder in einem Institut voreingestellt und anschließend an den Patienten gesandt wird.

Als besondere Ausgestaltung besitzt die vorliegende Erfindung die Möglichkeit, auch EEG-Signale und Blutdruckmeßwerte anderer ambulanter Geräte aufzunehmen. Über das EEG-Signal läßt sich somit auch die Schlaftiefe erfassen.

Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann darin gesehen werden, daß über einen Vergleich des Herzpotentialsignals mit dem Signal der Blut-Sauerstoffmessung die Pulswellen-Geschwindigkeit bzw. deren Veränderung bestimmt werden kann. Da diese mit den Schwankungen des Blutdrucks korreliert, ist zur Ermittlung dieser Schwankungen dann keine zusätzliche Blutdruckmessung mehr erforderlich.

Die erfindungsgemäße Vorrichtung ermöglicht nun ein Verfahren zur quantitativen Analyse von Schlafstörungen, bei dem ein mit einem Programm geladener Recorder von Meßsensoren aufgenommene Signale aufnimmt und speichert. Diese Daten werden danach (bei mobilem Einsatz) oder gleichzeitig (stationär) an eine Recheneinrichtung übertragen und von dieser verarbeitet. Die gemessenen und verarbeiteten Daten werden schließlich graphisch dargestellt.

Die Erfindung wird nachstehend mit Bezug auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

WO 97/14354 PCT/EP96/04497

Fig.	la) und	o) graphische Darstellungen einer Auswahl der
		erfaßten Größen als Funktion der Zeit in
		zwei unterschiedlichen Zeitintervallen,
Fig.	2 bis 6	Darstellungen einer Auswahl von Analyseer-
		gebnissen in Form von Tabellen (Fig. 2b, 3b,
		3d, 4a, 4c) und Diagrammen (Fig. 3a, 3c, 4b,
		5, 6) mit Patientendaten (Fig. 2a)
Fig.	7	eine schematische Darstellung der erfin-
		dungsgemäßen Vorrichtung,
Fig.	8	die Auswertung eines ersten Herzfrequenz-
		signals,
Fig.	9	die Auswertung eines zweiten Herzfrequenz-
		signals,
Fig.	10	die Auswertung eines respiratorischen Sig-
		nals,
Fig.	11	die Auswertung eines ersten Blut-Sauerstoff-
		sättigungssignals vom Pulsoximeter, und
Fig.	12	die Auswertung eines zweiten Blut-Sauer-
		stoffsättigungssignals vom Pulsoximeter.

In folgenden wird zunächst näher auf die verwendeten Sensoren und die von diesen gelieferten Meßsignale eingegangen. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist dazu in Fig. 7 schematisch dargestellt.

Die Atemgeräusche und Schnarchgeräusche des Patienten werden über ein am Larynx anzubringendes Elektretmikrophon 4 aufgenommen. Der Frequenzbereich dieses Mikrophons liegt dabei zwischen 50 bis 1500 Hz. Die von diesem Mikrophon gelieferte analoge Signalkurve wird rektifiziert und gefiltert, wonach die einhüllende Kurve mit einer über ein Konfigurationsmenü einstellbaren Frequenz abgetastet und digitalisiert wird. Der Atemfluß (Flow in Fig. 1) wird mittels eines Thermistors 5 oder eines Thermoelements gleichzeitig von Nase und Mund abgenommen. Dazu wird ein Summensignal gebildet, das zum einen die Atemfrequenzermittlung, zum anderen die Erkennung der Atemamplitude ermöglicht. Damit können zusammen mit den

im folgenden beschriebenen Sensoren für Thorax und Abdomen auftretende Apnoen gut unterschieden werden. Die thorakale Atembewegung wird mit einem piezokeramischen Sensor 6 aufgenommen, der in ein Verteilerkästchen 15 eingebaut ist, dem verschiedene Meßleitungen zusammenlaufen. Das Verteilerkästchen enthält Vorverstärker für die Meßaufnehmer. Für die abdominale Atembewegung wird ebenfalls ein piezokeramischer Sensor 7 eingesetzt. Zur Registrierung von Extremitätenbewegungen ist mindestens ein Aktographie-Sensor 8 vorgesehen. Dieser kann z.B. am Arm oder am Bein angebracht werden und bei der Verwendung eines zweiten Sensors, der über eine Y-Weiche mit dem ersten Sensor verbunden ist, lassen sich gleichzeitig Arm- und/oder Beinbewegungen feststellen. Mit diesen Aktographie-Sensoren lassen sich periodische Extremitätenbewegungen bestimmen, die sich im Vergleich zu Herzfrequenzvariationen zuordnen lassen. Zur Messung der Herzspannung wird auf das EKG-Verfahren zurückgegriffen. Dazu werden die drei Elektroden 9 an den standardisierten Stellen am Körper angebracht. Das analoge Herzpotential wird digitalisiert und als EKG-Signal gespeichert. Gleichzeitig wird das analoge EKG-Signal einer Spitzenwerterkennung zugeführt, um aus den zeitlichen Abständen zwischen den R-Zacken die Herzfrequenz bestimmen und speichern zu können. Die Messung der Sauerstoffsättigung des Blutes erfolgt mittels eines Pulsoximeters 10, dessen Sensor am Finger des Patienten angebracht wird. Ferner kann wie bei einer nasalen Überdrucktherapie über einen Drucksensor 11 der Beatmungsdruck direkt an der Maske während der Aufnahmezeit erfaßt werden. Der Drucksensor ist dabei mit einer Vorverstärkerelektronik und einer eigenen Stromversorgung in einem separaten Gehäuse eingebaut. Gemessen wird in einem Bereich von -10 mbar bis 30 mbar. Abschließend kann die Körperposition mittels eines Lagegebers 12, der z.B. aus vier Quecksilberschaltern besteht, ermittelt werden. Dieser Lagegeber zeigt stabil 5 Positionen an: rechts, links, Rückenlage, Bauchlage, aufrecht. dieser Lagegeber kann in dem Verteilerkästchen integriert sein. Der Lagegeber ermöglicht die Bestimmung der tatsächli-

PCT/EP96/04497

chen Zeit der Schlafposition und Zeiten unruhigen Schlafes, wodurch verschiedene Apnoephasen in Abhängigkeit von der Körperposition feststellbar sind, und auch Artefakte gut zugeordnet werden können. Ein besonderer Vorteil ist darin zu sehen, daß sowohl der Lagegeber als auch der Piezosensor für die thorakale Atembewegung in dem Verteilergehäuse integriert sind, wodurch die Anzahl der Meßpunkte am Körper des Patienten reduziert wird.

Im folgenden soll kurz der Ablauf einer Messung beschrieben werden.

Vor dem eigentlichen ambulanten oder stationären Betrieb wird die Vorrichtung über ein Ablaufprogramm auf der im Recorder 3 befindlichen Speicherkarte für die jeweilige Anwendung programmiert. Auf dieser Speicherkarte werden dann während der Aufzeichnung alle physiologischen Signale gespeichert. Die Programmierung des Recorders erfolgt durch das Einlesen eines Ablaufprogrammes für einen internen Mikroprozessor von der Speicherkarte, was sofort nach dem Einschieben der Speicherkarte geschieht. Der Recorder besitzt eine Echtzeituhr und kann auf einen bestimmten Startzeitpunkt bzw. Datum programmiert werden. Nach der Programmierung geht der Recorder in eine stromsparenden "Sleep-Modus" und wird von der Echtzeituhr zur programmierten Startuhrzeit und Datum geweckt und zu einer Stoppuhrzeit wieder abgeschaltet. Die Ablaufprogramme werden je nach medizinischer Fragestellung und der dafür notwendigen Konfiguration (Kanalzahl, Abtastraten, Startzeit, Stopzeit, Patientendaten usw.) einem Computer 1 auf die Speicherkarte geschrieben. Es können je nach Anwendung Speicherkarten (PCMCIA-ATA-Standard) zwischen 1,8 MByte und 170 MByte Speicherkapazität benutzt werden. Die verschiedenen Speicherkapazitäten der Speicherkarten ermöglichen es somit, die physiologischen Signale mit verschiedenen Abtastraten und mit verschiedenen Aufnahmezeiten über die Ablaufprogramme zu konfigurieren. Die auf die Speicherkarte aufgezeichneten physiologischen Daten werden nach dem Einlesen in den Computer als Rohdaten ohne irgendeine Verfälschung gespeichert und sind zu jeder Zeit neu analysier- und darstellbar. Im stationären Echtzeitbetrieb wird der Recorder direkt mit dem Computer über eine serielle Schnittstelle 2 verbunden, die zur Übertragung der Daten während der Aufzeichnung an den PC dient.

Um bei dem ambulanten Einsatz des Recorders die Möglichkeit der fehlerhaften Diagnose durch Fehlfunktion oder unsachgemäßen Gebrauch durch den Patienten zu minimieren, ist es dem Arzt im Nachhinein möglich, den korrekten Ablauf der Aufzeichnung zu kontrollieren. Dazu wird z.B. die Versorgungsspannung aufgezeichnet, wobei ein Unterschreiten einer bestimmten Versorgungsspannung die Aufzeichnung abbricht. Die bereits aufgezeichneten Daten sind jedoch voll auswertbar.

Die Funktionalität des Recorders und der Sensoren wird nach der Applikation durch die Echtzeitdarstellung am Computer kontrolliert. Falls kein Computer zur Verfügung steht, wird die Kontrolle der Applikation anhand von LED-Leuchten, die auf der Frontplatte des Recorders angebracht sind, durchgeführt. Nach Einlesen des Ablaufprogrammes wird daraufhin ein 5-minütiger Testmodus gestartet, bei dem die LED-Leuchten bei Betätigung eines entsprechend zugeordneten Sensors aufleuchten. Dieses Testprogramm kann durch Betätigen einer Markertaste 13 erneut gestartet werden. Die Markertaste ist vorgesehen, um dem Patienten die Möglichkeit zu geben, bestimmte Ereignisse, wie z.B. ein Aufwachen während der Nacht, zu markieren.

In den Figuren 2 bis 6 ist exemplarisch die Auswertung eines Meßzyklus abgebildet. Die Daten sind dabei auf verschiedene Weisen dargestellt. Signale, die bereits in der Rohfassung aussagekräftig sind, werden für einen gewünschten Zeitraum als Funktion der Zeit dargestellt. Die Daten der Blut-Sauerstoffmessung, der Lagesensoren, des Elektretmikrophons und der piezoelektrischen Sensoren zur Bestimmung der Atemtätig-

WO 97/14354 PCT/EP96/04497

keit werden nach statistischen Methoden ausgewertet und in Form von Tabellen bzw. Histogrammen veranschaulicht. Ebenfalls als Graph wird die Herzfrequenz-Verteilung (Fig. 4) dargestellt. Weiterhin ist wie in Fig. 1 gezeigt ist, eine bloße zeitliche Abhängigkeit der Daten anzeigbar. Insbesondere die zeitlichen Verläufe der Meßsignale lassen sich beliebig kombiniert darstellen und eine kombinierte Anzeige von respiratorischen und kardiologischen Parametern ermöglicht es, bestimmte Herzrhythmusstörungen den aufgetretenen Schlafstörungen zuzuordnen. Diese Herzrhythmusstörungen werden am besten in der zeitlichen Darstellung der Herzfrequenz beobachtet und während der Auswertung qualitativ und quantitativ erfaßt. Die Herzfrequenzvariationen werden dabei automatisch bestimmt und daraus ein Herzfrequenzvariationsindex berechnet. Um die zyklischen Herzfrequenzvariationen, welche durch Schlafapnoen induziert werden, von denen durch Myoklonien induzierten Variationen unterscheiden zu können, wird das Herzfrequenzsignal mit dem Signal des Aktographie-Sensors verglichen. Die respiratorischen Ereignisse, d.h. die schlafbezogenen Atmungsstörungen werden während der Auswertung ebenfalls quantitativ analysiert und durch verschiedene daraus berechnete Indizes beschrieben. Diese sind wie in Fig. 2 unten zu sehen ist, ebenfalls in Form einer Tabelle angezeigt. Durch die Anwendung besonderer Auswertealgorithmen, die noch im folgenden beschrieben werden, ermöglicht es die vorliegende Erfindung zwischen Hypopnoen und obstruktiven, zentralen oder gemischten Apnoen zu unterscheiden. Weiterhin werden bei der automatischen Analyse der Apnoen und Hypopnoen die aufgezeichneten Druckschwankungen der nasalen Überdrucktherapie anstelle des Atemflußsignales herangezogen, wodurch eine exakte Therapiekontrolle ermöglicht wird.

Mit dem umfassenden Datenmaterial, das mit der vorliegenden Erfindung einem behandelnden Arzt zur Verfügung gestellt wird, wird diesem ermöglicht, eine exakte Diagnose bezüglich Schlafstörungen, Atmungsstörungen, und Herzrhythmusstörungen zu treffen. Der zu behandelnde Patient kann daraufhin gezielt therapiert werden.

11

Beispielhaft sind folgende Korrelationen denkbar, die im Rahmen der Erfindung automatisch ausgeführt werden können:

- 1. Eine Korrelation zwischen Schnarchgeräuschen und Sauerstoffreduktion gibt Hinweise auf obstruktive Apnoen.
- 2. Eine Korrelation zwischen rhythmischen Beinbewegungn (PLMs, Myoklonien) und Herzfrequenz, ohne Schnarchen und ohne Sauerstoffentsättigungen, ergeben Hinweise auf den Einfluß von Beinbewegungen auf das Herz/Kreislauf-System mit Arousal-Effekt.
- 3. Arrhythmien ohne Korrelationen zu einem anderen Signal deuten auf absolute Arrhythmie hin.
- 4. Arrhythmie synchron zu den Atemsignalen deutet auf Sinus-Arrhythmien und Apnoe-assoziierte Arrhythmien hin.
- 5. Kompensatorische Arrhythmie ohne Korrelation mit anderen Signalen deutet auf Ventrikuläre Extrasystolen hin.
- 6. Regelmäßige Sauerstoff-Entsättigung mit synchroner Unterbrechung von Flow, sowie Thorax und Abdomenbewegung deutet auf zentrale Apnoen hin.
- 7. Langandauernde Sauerstoff-Entsättigungen mit evtl. unspezifischer Reduktion der Atmungsparameter und evtl. langsamer Änderung der Herzfrequenz, deuten auf eine obstruktive Lungenerkrankung hin.
- 8. Starke Apnoen mit starken synchronen Sauerstoff-Entsättigungen und geringen aber synchronen Herzfrequenzvariationen deuten auf Autonome Neuropathie hin (z.B. bei fortgeschrittenem Diabetes).

WO 97/14354 PCT/EP96/04497

- 9. Absinken der Herzfrequenz nach dem Wechsel von der aufrechten in die horizontale Lage deuten auf Einschlafen
 hin. Bei gleichzeitigem Einsatz von Apnoen oder PLM ist
 der Einschlafzeitpunkt mit geringer Fehlertoleranz feststellbar.
- 10. Unregelmäßige Veränderungen, die etwa alle 1 1/2 Stunden gleichzeitig in allen Signalen auftauchen und ca. 20 40 Minuten andauern, deuten auf REM-Schlaf (Traumschlaf) hin.
- 11. Regelmäßiges Schnarchen ohne Sauerstoffentsättigung aber mit zyklischen Herzfrequenzerhöhungen weisen auf eine UARS (Upper Airways Resistence Syndrome) hin.
- 12. Als Maß für die Obstruktion wird die Differenz zwischen den Absolutwerten von Thorax- und Abdomenbewegung ermittelt und in einem Diagramm (z.B. in einem zusätzlichen Kanal) dargestellt.

Im folgenden wird auf die Auswertealgorithmen bezüglich der Herzfrequenzanalyse, der Algorithmus zur Erkennung von Apnoen und Hypopnoen und dem Algorithmus zur Erkennung von Sauerstoffentsättigungen eingegangen.

Ausgewertet werden die physiologischen Daten einerseits visuell anhand der Rohdaten und andererseits durch die automatisierten Auswerteprogramme auf dem Computer.

Die automatische Herzfrequenzanalyse

Algorithmus zur Erkennung von Herzfrequenzvariationen (Apnoeassoziierte Sinusarrhythmie)

Es wird hier mit dem R-Zackenabstand, dem sogenannten Tachogramm gearbeitet. WO 97/14354 PCT/EP96/04497

Der Algorithmus arbeitet die Tabelle mit den Herzfrequenz-Werten wie folgt ab. Die $h_{\dot{1}}$ bezeichnen dabei die jeweiligen Herzfrequenzen, die Δ $h_{\dot{1}}$ die Differenzen aus den $h_{\dot{1}}$.

Algorithmus zur Erkennung von Herzfreguenzanstiegen

n = maximale Dauer für Anstieg

• for i = 1, ..., n Δ h_i = h_i - h_{i-1}

Aufnehmen der Δ h_i in den Integrationspuffer. Der Integrationspuffer ist ein Vektor mit Dimension n, der mit Nullen initialisiert ist.

Integrationspuffer = $\begin{pmatrix} \Delta h_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \Delta h_1 \\ 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \\ 0 \end{pmatrix}$

 Berechnen der Summe über die einzelnen Vektorelemente

Integral =
$$\sum_{k=0}^{n} \Delta h_k$$

• Fallunterscheidung

Integral <0:</pre>

Die Herzfrequenz-Kurve ist abgefallen. Der Integrationspuffer wird mit Nullen initialisiert

Integrationspuffer [i] = 0; i = 1, ..., n

0 < Integral < Schwelle:</pre>

Die Herzfrequenz-Kurve ist zwar angestiegen, aber nicht stark genug.

Integral > Schwelle:

Die Herzfrequenz-Kurve ist um mindestens den Schwellenwert angestiegen. Das erste Kriterium für ein Ereignis ist erfüllt.

 Suche nach dem Maximum
 Ab dem Beginn des Anstiegs wird nun nach dem Maximum gesucht. Dies wird durch Vergleichen der Herzfrequenz-Werte erreicht.

for n = 1, ..., Ende der Tabelle

eingelesener Wert > derzeitiges Maximum:

Wert = Maximum

Neuer Wert wird eingelesen

eingelesener Wert < derzeitiges Maximum:</pre>

| Wert-Maximum | ≤ Abbruchschwelle:

Die Herzfrequenz-Kurve ist wieder gefallen, aber nicht genug, als daß der Anstieg als beendet betrachtet werden könnte. Die Suche nach dem Maximum wird fortgesetzt.

| Wert-Maximum | > Abbruchschwelle:

Die Herzfrequenz-Kurve ist wieder abgefallen, und zwar mindestens um den Wert der Abbruchschwelle. Damit ist das Maximum gefunden. Von diesem gefundenen Maximum aus wird nun der Beginn und das Ende der Herzfrequenzvariation gesucht

• Suche nach dem Beginn des Anstieges

Nun wird rückwärts in der Zeit ab dem gefundenen Maximum nach dem Beginn des Anstieges, dem 1. Minimum,
gesucht. Die Suche erfolgt analog zur Maximumssuche.

Die Tabellenwerte werden soweit rückwärts durchlaufen, bis das Ende des vorausgehenden Anstieges erreicht wird, maximal aber bis zum "Ende des Suchintervalles für das erste Minimum", ein Wert der durch
den Benutzer vorgegeben werden kann.

for letztes Minimum, ..., Maximum:

eingelesener Wert < derzeitiges 1. Minimum:
Wert = 1. Minimum
Neuer Wert wird eingelesen.</pre>

eingelesener Wert > derzeitiges 1. Maximum:

| Wert - 1. Minimum | ≤ Abbruchschwelle:

Die Herzfrequenz-Kurve ist wieder angestiegen,
aber nicht genug, als daß der Beginn des Anstieges als erreicht betrachtet werden könnte.

Die Suche nach dem Beginn wird fortgesetzt.

| Wert - 1. Minimum | > Abbruchschwelle:
Die Herzfrequenz-Kurve ist wieder angestiegen,
und zwar mindestens um den Wert der Abbruchschwelle. Damit ist der Beginn des Anstieges
gefunden. Nun wird im nächsten Schritt das
Ende des Anstieges bestimmt.

WO 97/14354

• Suche nach dem Ende des Herzfrequenzanstieges

Nun wird vorwärts in der Zeit ab dem gefundenen Maximum nach dem Ende des Anstieges, dem 2. Minium,
gesucht. Die Suche erfolgt analog zur Suche nach dem
1. Minimum. Die Tabellenwerte werden soweit vorwärts
durchlaufen, bis ein Minimum gefunden wird, maximal
aber bis zum "Ende des Suchintervalles für das
zweite Minimum", ein Wert der durch den Benutzer
vorgegeben werden kann.

for i = 1, ..., n:

eingelesener Wert < derzeitiges 2. Minimum:
Wert = 2. Minimum
Neuer Wert wird eingelesen.</pre>

eingelesener Wert > derzeitiges 2. Minimum:

| Wert - 2. Minimum | ≤ Abbruchschwelle:

Die Herzfrequenz-Kurve ist wieder angestiegen,
aber nicht genug, als daß das Ende des Anstieges als erreicht betrachtet werden könnte. Die
Suche nach dem Ende wird fortgesetzt.

| Wert - 2. Minimum | > Abbruchschwelle: Die Herzfrequenz-Kurve ist wieder abgesunken, und zwar mindestens um den Wert der Abbruchschwelle. Damit ist das 2. Minimum gefunden.

Analog zur SaO₂-Analyse spielen auch hier die einzelnen Parameter eine wichtige Rolle. Da das Herzfrequenzsignal wesentlich komplexer als das SaO₂-Signal ist, treten hier bestimmte Phänomene verschärft auf. In Fig. 8 ist beispielhaft die Herzfrequenz-Analyse dargestellt.

Die Analyseparameter der Herzfrequenzanalyse

Auch hier werden die einzelnen einstellbaren Parameter noch einmal genau erläutert.

- minimaler Herzfrequenz-Anstieg ϵ [1, 30] Dieser Wert legt fest, wie stark die Herzfrequenzkurve ansteigen muß, damit die Suche nach dem Maximum eingeleitet wird. Im Algorithmus ist dieser Wert die Integrationsschwelle.
- maximales Zeitintervall für Hf-Anstieg ϵ [1, 250] Dieser Wert beschränkt die Dauer, in der der Abfall der Hf-Kurve erfolgen muß. Im Algorithmus bedeutet er die Dimension des Integrations-Puffers.
- Abbruchschwelle für Min-Max-Suche ε [1, 10]
 Die Abbruchschwelle ist das Abbruchkriterium für eine Minimums- oder Maximumssuche bei einer Veränderung der Hf-Kurve um diesen Betrag.
- minimale und maximale Ereigniszeit ε [1, 250]
 Diese beiden Parameter sind letztendlich entscheidend dafür, ob ein gefundener Herzfrequenz-Anstieg als Ereignis in die Ereignisliste aufgenommen wird oder nicht. Um als Ereignis aufgenommen zu werden, muß für die Dauer des Anstieges gelten:
 min. Ereigniszeit <(t_{2.Min} = t_{1.Min}) < max. Ereigniszeit
- Suchintervall für das Maximum ϵ [1, 30] Es begrenzt die Suchumgebung für die Suche nach dem Maximum von einem aktuellen und damit zeitweiligen Maximum aus.

WO 97/14354 PCT/EP96/04497

• Suchintervall für das erste Minimum ϵ [1, 30] Dieses Suchintervall begrenzt die Suchumgebung für die Suche nach dem Beginn des Herzfrequenzanstieges. Dieses Intervall ist ein zweites Abbruchkriterium nach der Abbruchschwelle. Es verhindert, daß sich der Algorithmus zu Tode läuft, wenn die Herzfrequenz in ein Plateau mündet (Fig. 8).

• Suchintervall für das zweite Minimum ε [1, 30]
Dieses Suchintervall begrenzt die Suchumgebung für die Suche nach dem Ende des Anstieges. Dieses Intervall ist ein zweites Abbruchkriterium nach der Abbruchschwelle. Es verhindert, daß sich der Algorithmus zu Tode läuft, wenn die Herzfrequenzkurve in ein Plateau mündet (Fig. 9).

Die Grundeinstellung der Parameter ist:

•	minimaler Herzfrequenz-Anstieg:	8		
•	Abbruchschwelle für Min-Max-Suche:			8
•	Suchintervall für das Maximum:	30	s	
•	Suchintervall für das erste Minimum:			10 s
•	Suchintervall für das zweite Minimum:			10 s
•	minimale Ereigniszeit:	5	s	
•	maximale Ereigniszeit:	150	s	

Die respiratorischen Kanäle

Algorithmus zur Erkennung von Apnoen und Hypopnoen

Der Algorithmus arbeitet in drei Schritten:

- Filterung der vorhandenen Daten
- Berechnung der Grenzwerte
- Durchführung der Analyse anhand der aufbereiteten Daten

Die Filterung der Daten ist notwendig, da das Signal der respiratorischen Kanäle kompliziert und störungsanfällig ist. Die Filterung erfolgt gleitend, immer über 1 Sekunde, das entspricht 250 Abtastwerten.

Filterung der Daten:

Die f_i entsprechen den Abtastwerten des jeweiligen respiratorischen Kanals.

for
$$i = 1, ..., 250$$

 $\Delta f_i = f_i - f_{i-1}$

Aufnehmen der Δf_i in den Differenzpuffer. Der Differenzpuffer ist ein Vektor mit Dimension 250, der mit Nullen initialisiert ist.

Differenzpuffer =
$$\begin{pmatrix}
\Delta f_1 \\
\cdot \\
\cdot \\
\Delta f_i \\
0 \\
\cdot \\
\cdot \\
0
\end{pmatrix}$$

Berechnung der Summen für den Integralpuffer

$$sum_{k} = \sum_{k=1}^{i} \Delta f_{i}$$

Integral puffer =
$$\begin{bmatrix} sum_1 \\ . \\ . \\ sum_k \\ 0 \\ . \\ . \\ 0 \end{bmatrix}$$

WO 97/14354

Mit diesen Werten wird nun weitergearbeitet.

Eine Apnoe oder Hypopnoe sind dadurch gekennzeichnet, daß die Atemkurve um einen gewissen Prozentsatz im Vergleich zur vorausgehenden Atmung absinkt. Da es sich bei der Atmung stets um eine sinuidale Kurve handelt und diese in seiner Amplitude auch bei gesunden Menschen schwankt, muß der Mittelwert über die vorausgehenden Atemzüge berechnet werden, damit ein Absinken der Atmung erkannt werden kann. Dies geschieht mit folgendem Algorithmus:

Algorithmus zur Bestimmung der Apnoe-/Hypopnoegrenzen
Der Mittelwert wird über die Minima und Maxima der letzten
10 Atemzüge berechnet.

Erkennung des Maximums:

 $sum_i > 0:$

falls $sum_{i+1} > max > 0$, d.h. die Atemkurve befindet sich noch im Ansteigen,

 $dann max = sum_{i+1}$

falls sum $_{i+1}$ < 0, d.h.. die Kurve hat das Maximum längst überschritten,

dann ist das letzte berechnete Maximum gültig.

Erkennung des Minimums:

 $sum_i < 0:$

 $\label{eq:falls_sum_i+1} \text{ falls } \text{sum}_{\text{$i+1$}} \text{ < min < 0, d.h. die Atemkurve} \\ \text{befindet sich noch im Fallen,}$

 $dann min = sum_{i+1}$

falls $sum_{i+1} > 0$, d.h. die Kurve hat das Minimum längst überschritten,

dann ist das letzte berechnete Minimum gültig.

Über die Betäge der errechneten Minima und Maxima wird dann der Mittelwert gebildet:

$$\sum_{i=1}^{5} | \min_{i} | + \max_{i}$$
Mittel =
$$\frac{10}{10}$$

Die Apnoe-/Hypopnoegrenzen berechnen sich dann aus

wobei die Ereignisschwelle in Prozent eingestellt werden kann.

Nun sind alle Hilfsmittel für die Analyse bereitgestellt.

Algorithmus zur Erkennung von Apnoen und Hypopnoen

for i = 1, ..., 250

falls | sum; | < Grenze,

setze Zähler = 0 und beginne zu zählen.

falls | sum; | > Grenze,

überprüfe, wie weit der Zähler gelaufen ist. Gilt: minimale Ereigniszeit < Zähler < maximale Ereigniszeit

dann wurde eine Apnoe oder eine Hypopnoe gefunden.

Diese Analyse wird auf allen respiratorischen Kanälen vollzogen. Obstruktive und zentrale Apnoe werden anhand der Thorax- und Abdomenaktivität differenziert. Sinkt die Atmung an Mund und Nase ab; überprüft das Programm, ob korreliert dazu die Aktivität auch an Thorax und Abdomen zurückgeht. Ist dies der Fall liegt eine zentrale Apnoe vor. Fig. 10 verdeutlicht die Analyse zur Erkennung von Apnoen.

Die Analyseparameter der Apnoeanalyse

Die Parameter bei der Apnoe-Analyse sind durch die medizinische Diagnostik festgelegt. Folgende Parameter sind einstellbar:

• Apnoe-Schwelle

Damit eine Apnoe diagnostiziert werden kann, muß die Atemkurve um mindestens 80 % gegenüber dem Mittelwert über die letzten 10 Atemzüge absinken. Dieser Wert entspricht im Algorithmus der Ereignisschwelle

minimale Apnoezeit

Dieser Wert begrenzt das Zeitintervall, in der die Atemkurve unter der Apnoeschwelle liegen muß. Die minimale Apnoezeit muß mindestens 10 Sekunden betragen.

Hypopnoe-Schwelle

Damit eine Hypopnoe diagnostiziert werden kann, muß die Atemkurve um mindestens 50 % gegenüber dem Mittelwert über die letzten 10 Atemzüge absinken. Dieser Wert entspricht im Algorithmus der Ereignisschwelle.

minimale Hypopnoezeit

Dieser Wert begrenzt das Zeitintervall, in der die Atemkurve unter der Hypopnoeschwelle liegen muß. Die minimale Hypopnoezeit muß mindestens 10 Sekunden betragen.

- zentrale Apnoeschwelle
 Bei einer zentralen Apnoe muß die Amplitude der Thoraxund Abdomensignale um mindestens 80 % gegenüber dem Mittelwert über die letzten 10 Atemzüge absinken.
- minimale zentrale Zeit
 Dieser Wert begrenzt das Zeitintervall, in der die Thorax- und Abdomenkurven unter der zentralen Apnoeschwelle liegen müssen. Die minimale zentrale Apnoezeit muß mindestens 5 Sekunden betragen.
- maximale Dauer
 Dieser Wert beschränkt die maximale Dauer einer signifikanten Amplitudenreduktion für ein Ereignis.

Der Sauerstoffsättigungskanal

Algorithmus zur Erkennung von Entsättigungen

Ziel des Algorithmus ist die Sauerstoffentsättigungen zu erkennen. Da die Sauerstoffsättigung sehr hoch abgetastet wird, ist eine Datenreduktion nötig, damit die Analyse zügig erfolgen kann. Diese Datenreduktion geschieht, indem eine Tabelle erstellt wird, die jeweils den Mittelwert über eine Sekunde enthält. Dies bedeutet keine starke Einbuße an Information, da sich die Sauerstoffsättigung im Blut im Vergleich zur Herzfrequenz innerhalb einer Sekunde wenig ändert. Der Algorithmus durchsucht diese Tabelle dann nach signifikanten Ereignissen.

Dabei bedeuten die S_i die jeweiligen SaO_2 -Werte aus der Tabelle und die Δ S_i die Differenzen aus den S_i .

Algorithmus zur Erkennung von Sauerstoffentsättigungen

n = maximale Dauer für Abstieg

• for i = 1, ..., n

$$\Delta S_i = S_i - S_{i-1}$$

Aufnehmen der ΔS_i , in den Integrationspuffer. Der Integrationspuffer ist ein Vektor mit Dimension n, der mit Nullen initialisiert ist.

Integrationspuffer = $\begin{bmatrix} \Delta S_1 \\ \cdot \\ \cdot \\ \Delta S_i \\ 0 \\ \cdot \\ \cdot \\ 0 \end{bmatrix}$

 Berechnen der Summe über die einzelnen Vektorelemente

Integral =
$$\sum_{k=0}^{n} \Delta S_k$$

• Fallunterscheidung

Integral > 0:

Die SaO₂-Kurve ist angestiegen, d.h. keine Entsättigung ist indiziert. Der Integrationspuffer wird mit Nullen initialisiert.

Integrationspuffer [i] = 0; i = 1, ..., n

Schwelle > Integral > 0:

Die SaO₂-Kurve ist zwar abgefallen, aber nicht stark genug, als daß es sich um eine Entsättigung handeln könnte.

Integral < Schwelle:</pre>

Die SaO₂-Kurve ist um mindestens den Schwellenwert abgesunken. Das erste Kriterium für eine Entsättigung ist erfüllt.

Suche nach dem Minimum
 Ab dem Beginn des Absinkens wird nun nach dem Minimum gesucht. Dies wird durch Vergleichen der SaO₂-Werte erreicht.

for n = 1, ..., Ende der Tabelle

eingelesener Wert < derzeitiges Minimum:

Wert = Minimum

Neuer Wert wird eingelesen.

eingelesener Wert > derzeitiges Minimum:

| Wert-Minimum | ≤ Abbruchschwelle:

Die SaO₂-Kurve ist wieder angestiegen; aber nicht genug, als daß die Entsättigung als beendet betrachtet werden könnte. Die Suche nach dem Minimum wird fortgesetzt.

| Wert-Minimum | > Abbruchschwelle:

Die SaO₂-Kurve ist wieder angestiegen, und zwar mindestens um den Wert der Abbruchschwelle. Damit ist das Minimum gefunden. Von diesem gefundenem Minimum aus wird nun der Beginn und das Ende der Entsättigung gesucht.

WO 97/14354

26

• Suche nach dem Beginn der Entsättigung
Nun wird rückwärts in der Zeit ab dem gefundenen Minimum nach dem Beginn der Entsättigung, dem 1. Maximum, gesucht. Die Suche erfolgt analog zur Minimumssuche. Die Tabellenwerte werden soweit rückwärts durchlaufen, bis das Ende der vorausgehenden Entsättigung erreicht wird, maximal aber bis zum "Ende des Suchintervalles für das erste Maximum", ein Wert der durch den Benutzer vorgegeben werden kann.

for letztes Maximum, ..., Minimum:

<u>eingelesener Wert > derzeitiges 1. Maximum:</u>

Wert = 1. Maximum

Neuer Wert wird eingelesen.

eingelesener Wert < derzeitiges 1. Maximum:

| Wert - 1. Maximum | ≤ Abbruchschwelle:

Die SaO₂-Kurve ist wieder abgesunken, aber nicht genug, als daß der Beginn der Entsättigung als erreicht betrachtet werden könnte. Die Suche nach dem Beginn wird fortgesetzt.

| Wert - 1. Maximum | > Abbruchschwelle:

Die SaO₂-Kurve ist wieder abgesunken, und zwar mindestens um den Wert der Abbruchschwelle. Damit ist das 1. Maximum gefunden, da jetzt die vorhergehende Entsättigung erreicht wurde. Nun wird im nächsten Schritt das Ende der Entsättigung bestimmt.

Suche nach dem Ende der Entsättigung
 Nun wird vorwärts in der Zeit ab dem gefundenen Minimum nach dem Ende der Entsättigung, dem 2. Maximum, gesucht. Die Suche erfolgt analog zur Suche

nach dem 1. Maximum. Die Tabellenwerte werden soweit vorwärts durchlaufen, bis ein Maximum gefunden wird, maximal aber bis zum "Ende des Suchintervalles für das zweite Maximum", ein Wert der durch den Benutzer vorgegenen werden kann.

for i = 1, ..., n:

eingelesener Wert > derzeitiges 2. Maximum:
Wert = 2. Maximum
Neuer Wert wird eingelesen.

eingelesener Wert < derzeitiges 2. Maximum:

| Wert - 2. Maximum | ≤ Abbruchschwelle:

Die SaO₂-Kurve ist wieder abgesunken, aber

nicht genug, als daß das Ende der Entsättigung

als erreicht betrachtet werden könnte. Die Su
che nach dem Ende wird fortgesetzt.

| Wert - 2. Maximum | > Abbruchschwelle: Die SaO₂-Kurve ist wieder abgesunken, und zwar mindestens um den Wert der Abbruchschwelle. Damit ist das 2. Maximum gefunden, da jetzt die folgende Entsättigung erreicht wurde.

Dies war die Beschreibung des Grundalgorithmus. Eine wichtige Rolle für das effektive Funktionieren des Algorithmus spielt die richtige Wahl der Analyseparameter. Veranschaulicht wird die SaO₂-Analyse in Fig. 11.

Die Analyseparameter der SaO2-Analyse

Wie bereits erwähnt, hängt die Effektivität des Algorithmus von der Wahl der geeigneten Parameter ab. Sämtliche Parameter sind frei einstellbar. Diese sollen im folgenden noch einmal detailliert beschrieben werden.

- minimaler SaO₂-Abfall ∈ [-10, -1] Dieser Wert legt fest, um wieviel Prozent die Sauerstoffsättigungskurve abfallen muß, damit die Suche nach dem Minimum eingeleitet wird. Im Algorithmus ist dieser Wert die Integrationsschwelle.
- maximales Zeitintervall für SaO_2 -Abfall ϵ [1, 250] Dieser Wert beschränkt die Dauer, in der der Abfall der SaO_2 -Kurve erfolgen muß. Im Algorithmus bedeutet er die Dimension des Integrations-Puffers.
- Abbruchschwelle für Min-Max-Suche ϵ [1, 10] Die Abbruchschwelle ist das Abbruchkriterium für eine Minimums- oder Maximumssuche bei einer Veränderung der SaO₂-Kurve um diesen Betrag.
- minimale und maximale Ereigniszeit ∈ [1, 250]
 Diese beiden Parameter sind letztendlich entscheidend dafür, ob eine gefundene Entsättigung als Ereignis in die Ereignisliste aufgenommen wird oder nicht. Um als Ereignis aufgenommen zu werden, muß für die Dauer der Sauerstoffentsättigung gelten min. Ereigniszeit < (t_{2.Max} t_{1.Max}) < max Ereigniszeit
- Suchintervall für das Minimum ϵ [1, 30] Es begrenzt die Suchumgebung für die Suche nach dem Minimum von einem aktuellen und damit zeitweiligen Minimum aus.
- Suchintervall für das erste Maximum ϵ [1, 30] Dieses Suchintervall begrenzt die Suchumgebung für die Suche nach dem Beginn der Sauerstoffentsättigung. Dieses Intervall ist ein zweites Abbruchkriterium nach der Abbruchschwelle. Es verhindert, daß sich der Algorithmus zu Tode läuft, wenn die Sauerstoffsättigung in ein Plateau läuft.

• Suchintervall für das zweite Maximum ϵ [1, 30] Dieses Suchintervall begrenzt die Suchumgebung für die Suche nach dem Ende der Sauerstoffentsättigung. Dieses Intervall ist ein zweites Abbruchkriterium nach der Abbruchschwelle. Es verhindert, daß sich der Algorithmus zu Tode läuft, wenn die Sauerstoffsättigung in ein Plateau läuft (Fig. 12).

Die Grundeinstellung der Parameter ist:

•	minimaler SaO ₂ -Abfall:			-4 %
•	Abbruchschwelle für Min-Max-Suche:	2	%	
•	Suchintervall für das Minimum:	30	s	
•	Suchintervall für das erste Maximum:			30 s
•	Suchintervall für das zweite Maximum:	30	s	
•	minimale Ereigniszeit:			5 s
•	maximale Ereigniszeit:			150 s

WO 97/14354 PCT/EP96/04497

<u>Patentansprüche</u>


30

- 1. Vorrichtung zur qualitativen und/oder quantitativen Analyse von Schlafstörungen, mit mehreren Sensoren zur Messung von Körperfunktionen, einem mit den Sensoren verbundenen mobilen Recorder zur Aufnahme der Meßsignale der Sensoren, und einer mit dem Recorder verbundenen Recheneinrichtung zur Speicherung und Auswertung der Meßsignale, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ein Sensor aus der folgenden Gruppe vorgesehen ist:
 - (a) Mittel (4) zur Erfassung von Atmungslauten,
 - (b) Mittel (11) zur Erfassung des Beatmungsdrucks,
 - (c) Mittel (5) zur Erfassung des Atemflusses,
 - (d) Mittel (6, 7) zur Erfassung der Atemtätigkeit,
 - (e) Mittel (9) zur Erfassung des Herzpotentials,
 - (f) Mittel (10) zur Erfassung des Blut-Sauerstoffgehaltes,
 - (g) Mittel (12) zur Erfassung der Körperlage,
 - (h) Mittel (8) zur Erfassung der Körperbewegungen, und
 - (i) Mittel zur Erfasssung elektrophysiologischer Parameter.
- Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Mittel (4) zur Erfassung von Atmungslauten ein Elektretmikrophon aufweisen.
- 3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Mittel (9) zur Abtastung des Herzpotentials drei EKG-Elektroden aufweisen.
- 4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Mittel (10) zur Erfassung des Blut-Sauerstoffgehalts ein Pulsoximeter mit verschiedenen Sensoren aufweisen.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei die Mittel zur Erfassung der Körperlage (12) vier Quecksil-


- berschalter zur Erfassung von fünf Lagepositionen aufweisen.
- 6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei die Mittel (8) zur Erfassung der Körperbewegungen ein Piezoelement aufweisen.
- 7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die Mittel (11) zur Erfassung des Beatmungsdrucks einen Drucksensor aufweisen.
- 8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Mittel (5) zur Erfassung des Atemflusses ein Thermoelement aufweisen.
- 9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei die Mittel (5) zur Erfassung des Atemflusses einen Thermistor aufweisen.
- 10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei die Mittel (6, 7) zur Erfassung der Atemtätigkeit ein Piezo-element aufweisen.
- 11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, wobei die Mittel (6) zur Erfassung der Atemtätigkeit in die Mittel (12) zur Erfassung der Körperlage integriert sind.
- 12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wobei weiterhin Mittel (14) zur Aufnahme externer ambulanter Signale vorgesehen sind.
- 13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei mindestens ein Alarmgeber vorgesehen ist.
- 14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei ein Alarmgeber den Blut-Sauerstoffgehalt überwacht.

WO 97/14354

- 15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei ein Alarmgeber die Herzfrequenz überwacht.
- 16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 15, wobei Mittel zur Berücksichtigung von Störsignalen vorgesehen sind.
- 17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, wobei die Vorrichtung einer gewünschten Anwendung entsprechend programmierbar ist.
- 18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, wobei die Vorrichtung für stationären oder mobilen Betrieb geeignet ist.
- 19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 18, mit einer Einrichtung zur Korrelation und/oder zum Vergleich von respiratorischen und kardiologischen Signalen.
- 20. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 19, mit einer Einrichtung zum Bestimmen der Veränderung der Pulswellengeschwindigkeit.
- 21. Verfahren zur quantitativen Analyse von Schlafstörungen, gekennzeichnet durch die Schritte:
 - Programmieren eines Aufzeichnungsgeräts (3) entsprechend einer gewünschten Untersuchung,
 - Aufnehmen von Daten, die von mindestens einem Sensor geliefert werden, gesteuert durch das Aufzeichnungsgerät (3),
 - Liefern der Daten an eine Recheneinrichtung (1) zur Auswertung,
 - Auswerten der Daten mittels Korrelation der Signalverläufe sowie Ableitung weiterer Daten aus den aufgenommenen Daten, und
 - Darstellen der Daten in Form von Signalverläufen, Tabellen und/oder Histogrammen.

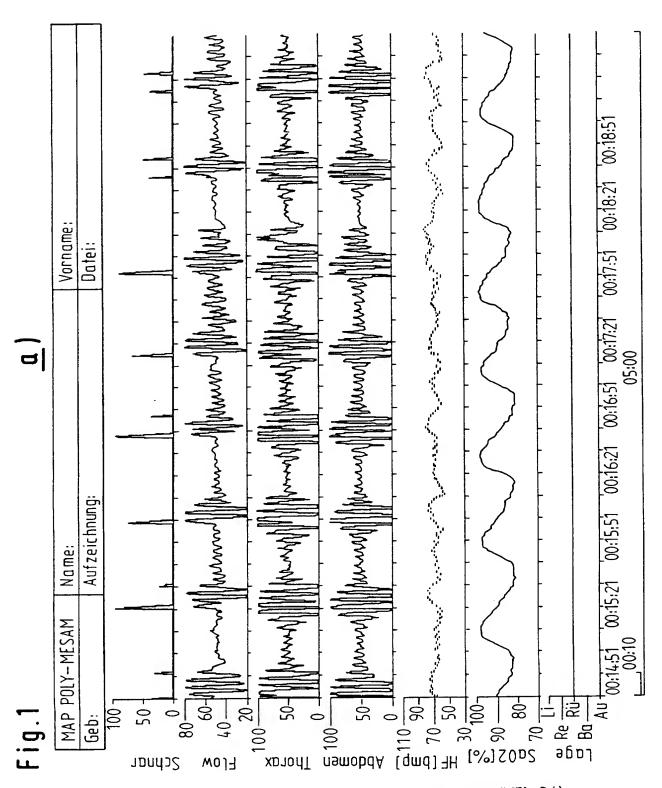

BERICHTIGTES BLATT (REGEL 91)
ISA/EP

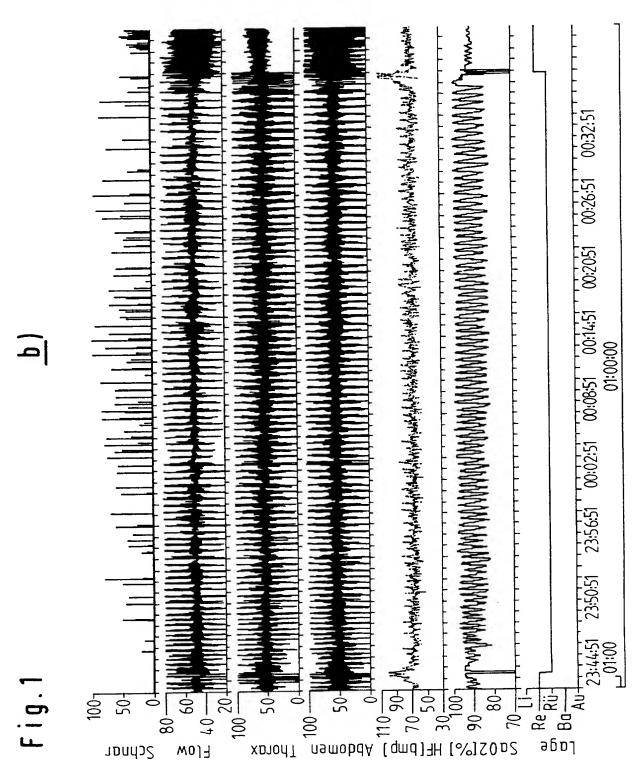

BERICHTIGTES BLATT (REGEL 91) ISA/EP

3 / 11 **Fig. 2**

MAP Medizintechnik für Arzt u. Patient	POLY-MESAM S/W: V 1.1, H/W: PolyMesam

Patient :	geb.	:	PID:	
Aufzeichnung:		Datei:		Arzt:

<u>a</u>)

1. Patientendaten			
Dateiname :	Arzt	:	
Name :	PID	:	
Vorname :	Geschlecht Größe	•	
Geb.datum : Straße :	Gewicht	:	
Wohnort :	Broca Index	:	
Telefon :	Diastol. Druck	:	

2. Aufzeichnung		
Aufzeichnungszeitraum Auswertungszeitraum Sa02 – Artefakte	:	26.9.1995 : 20:00:02 - 07:01:02

<u>b</u>)

A. Indizes		
Parameter	Phasen / Stunde	Korrelation zum RDI
RDI	60	-
Apnoeindex	47	80 %
Hypopnoeindex	12	20 %
Entsättigungsindex	58	66 %
Herzfrequenzvariationsindex	0	0 %
Mobilitätsindex	3	0 %

Fig. 3


4/11

J	
MAP Medizintechnik für Arzt u. Patient	POLY-MESAM S/W: V 1.1, H/W:PolyMesam
Patient:	geb.: PID:
Aufzeichnung:	Datei: Arzt:
<u>Dauer</u> Ergebnisse der Apnoeanalyse Sek.	obstruktiv gemischt zentral Hypopnoen
	19 4 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

<u>b</u>)

<u>a</u>

B. Ergebnisse der Apnoeanalyse							
Klasse	alle	1020s	> 20 s	>40 s	mittl.Dauer	max. Dauer	Index
obstruktiv	140	121	19	2	16 s ± 7	54 s	17
gemischt	196	145	51	1	19 s ± 6	46 s	24
zentral	44	40	4	0	15 s ± 4	23 s	5
gesamt	380	306	74	3	17 s ± 6	54 s	47
Hypopnoen	97	96	1	1	14 s ± 8	86 s	12

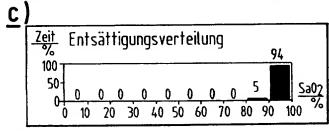

Anzahl Entsättigungsdauer								
150 137 1 100 7 50 7	32 11 3 2	0 0 0 0 0	<u>Dauer</u> Sek					
U	50	100						

<u>d)</u>

C. Ergebnisse der Entsättigungsan	alyse	
Sauerstoffsättigung	Sa02 <= 100 %	Sa02 < = 90 %
Tiefste Entsättigung Mittleres Minimum Mittlere Sättigung Mittlere basale Sättigung	71% 90%±3 95%±2 96%±3	71 % 87 % ± 0 87 % ± 0 87 % ± 0
Maximale Dauer Mittlere Dauer Anzahl der Entsättigungen	76 s 26 s ± 2 465	76 s 31 s ± 0 172
Entsättigungsindex	58 / h	21 / h

Fig. 4 5/11


MAP Medizintechnik für Arzt u. Patient	POLY-MESAM S/W: V1.1, H/W: PolyMesam

Patient:	geb.:	PID:	
Aufzeichnung:	Datei:	Arzt:	

<u>a</u>)

D. Ergebnisse des Körperpositionsgeber, absolut und bezogen auf Apnoen					
Körper- position	verbrachte Zeit		roen Index	Mittlere Dauer der Apnoen	Apnoen/ Lage
Links Rechts	1:10:25 1:56:35	72 122	9 1 5	20 s ± 9 16 s ± 5	19 % 32 %
Rücken Bauch	2:20:40 0:03:43	173 4	22	18 s ± 5 22 s ± 7	46 % 1 %
Aufrecht	2:28:47	9	1	12 s ± 1	2%
Alle	8:00:10	380	47	17 s ± 6	100 %
Summe aller Lag Mobilitätsindex (jewechsel Lagewechsel/Stund	= 23 e) = 3			

<u>b</u>)

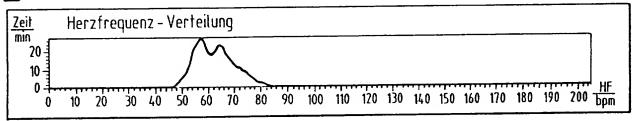

<u>c</u>)

E. Schnarchen , Herzfrequenz				
Schnarchen	Auswertu absolut	ngsdauer relativ	Herzfrequenz	
Ohne Schnarchen Mit Schnarchen Mit Lautem Schnarchen	0:06:26 0:11:31 7:42:13	1% 2% 96%	66 bpm ± 2 66 bpm ± 3 63 bpm ± 8	
Summe	8:00:10	100 %	63 bpm ± 8	
Mittlere Herzfrequenzerhöhung	mit Schnarchen/oh	ne Schnarchen:	96.1 %	

Fig.5

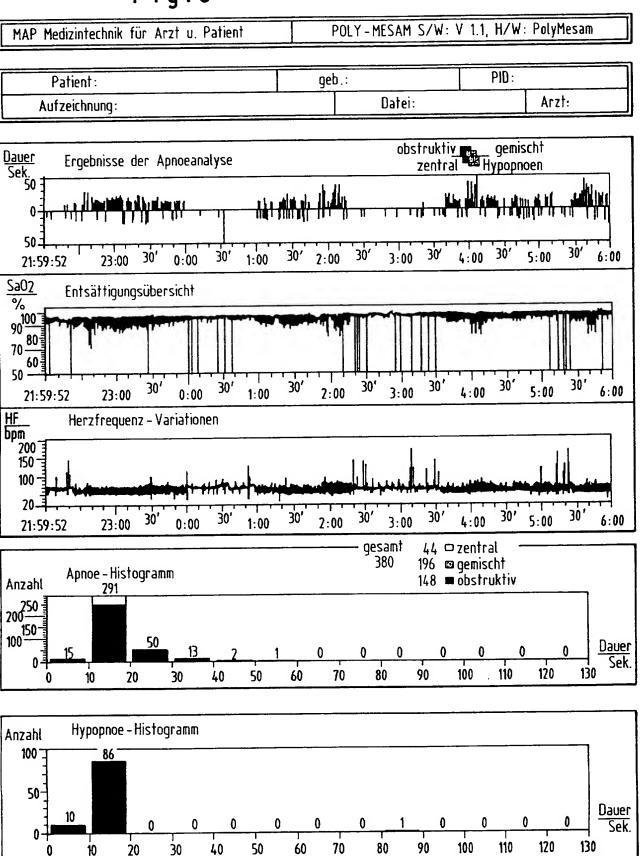
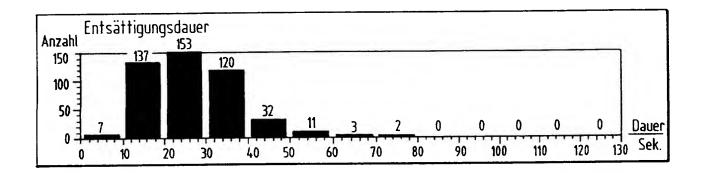
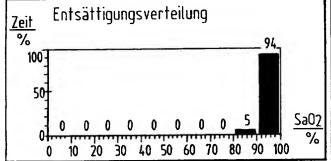


Fig.6

MAP Medizintechnik für Arzt u. Patient	POLY-MESAM S/W: V 1.1, H/W: PolyMesam			

Patient:	geb.:	PID:	
Aufzeichnung:	Datei:	Arzt:	








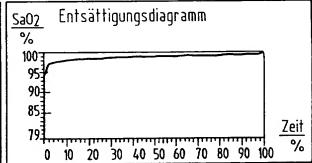


Fig.7

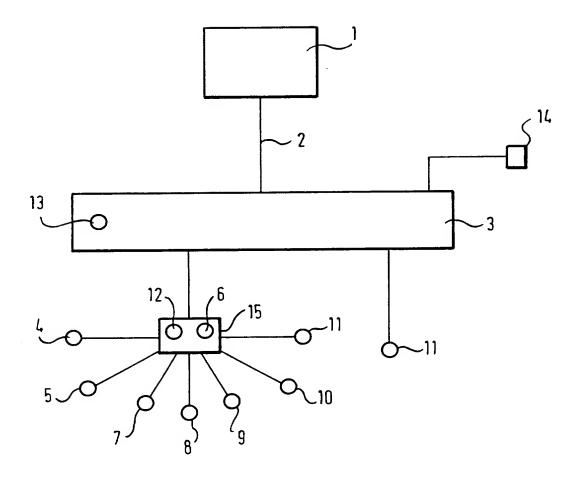

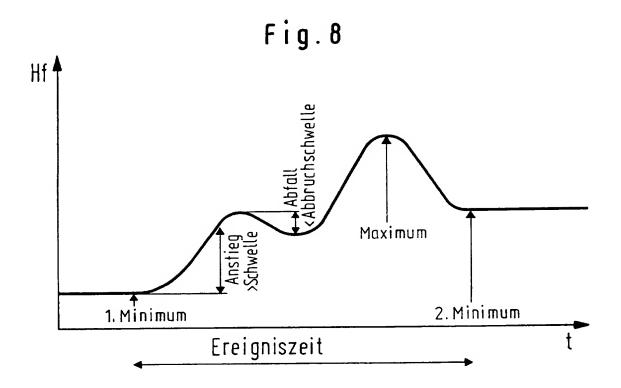

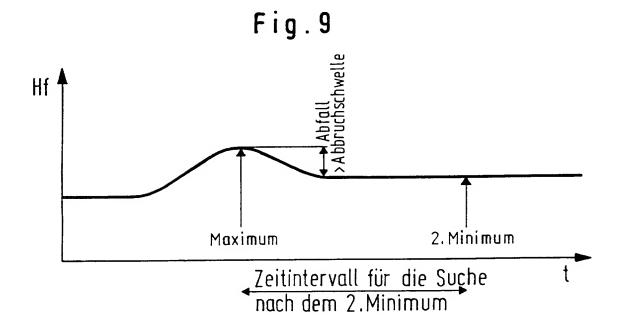

ERSATZBLATT (REGEL 26)

Fig. 10


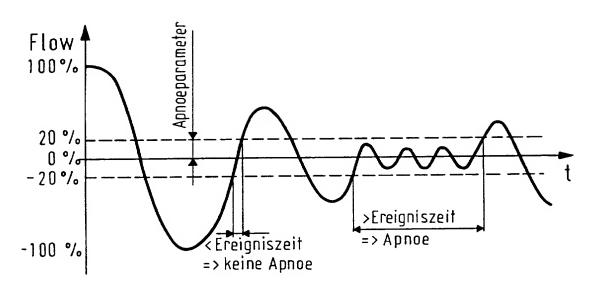


Fig.11



ERSATZBLATT (REGEL 26)

Fig. 12

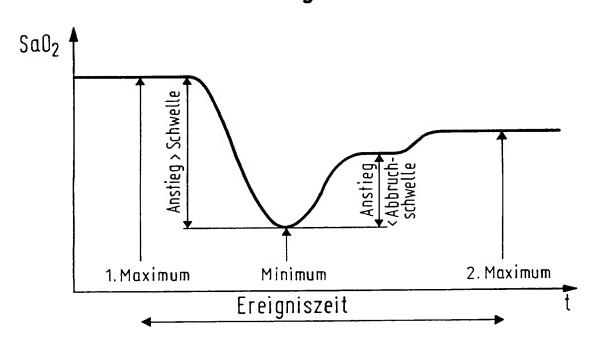